SOARMED

RV-500

日本動物專用32KW高頻X光機

Canon 專用高階管球
E7846

源自日本品質

- 業界最小雙焦點 0.6mm / 1.3mm
- 日本原機進口
- 業界唯一110V電源插座即可使用
- 出廠輻射洩漏測試報告
- 運轉靜音設計不怕嚇到毛小孩
- 無風扇設計不卡毛

看不見的安全守護

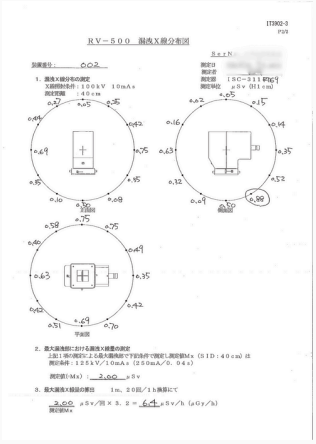

原廠輻射洩漏測定

秉持日本職人精神，追求最小洩漏量的設計，出廠前再次進行整機測試，每一台機器都有原廠檢附報告，為每一位使用者做好第一道安全的把關。

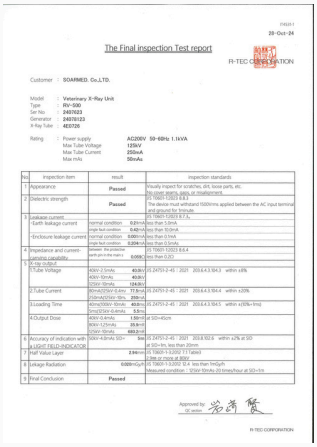

原廠「整機」QC報告

符合・日本相關規範，並出具品管報告

一般要求事項 JIS T0601-1:1999

医用X線装置通則 JIS Z4701:1997

医用X線機械装置通則 JIS Z4703:1995

診斷用一體化X線發生裝置JISZ4711:2006

診斷用X線準值儀 JIS Z4712:1998

Canon E7846 雙焦點

0.6/1.3 mm

細小雙焦點組合、呈現細膩影像！

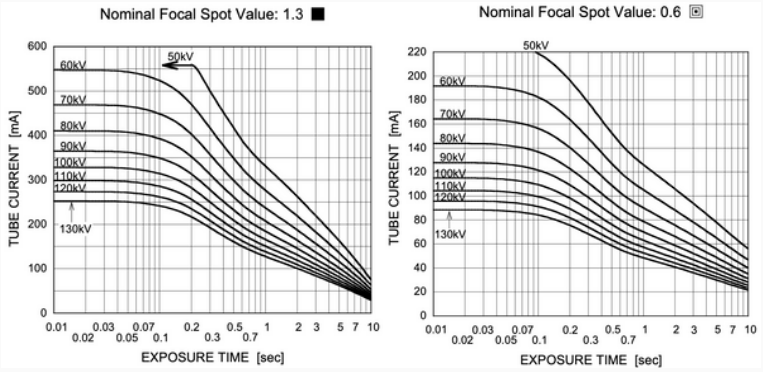

資料來源：日本 Canon E7846 Datasheet

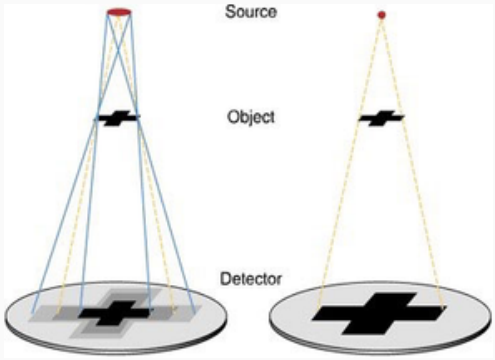

三千多組參數與動物面板

- 追求極短的曝光時間、減少呼吸晃動
- 圖像式面板設計，醫護人員容易上手

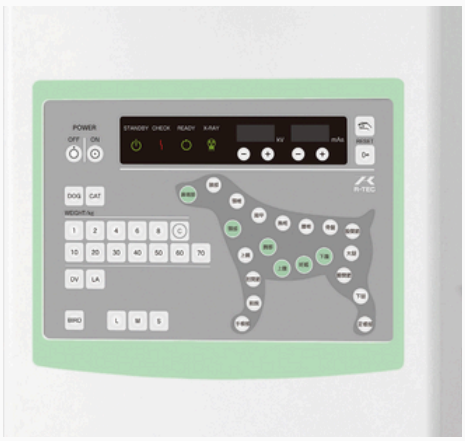

無風扇設計、不卡毛

寧靜、平滑、容易清理！

規 格		
額定	攝影管電壓	40~125kV (2kV/step)
	攝影管電流	最大250mA (依據KV、mAs值自動設定最大容許管電流)
	攝影mAs	0.4~50.0 mAs
	攝影時間	0.005~0.2 sec (最小分解0.001sec)
輸入電源	單相AC	AC110V – 240V、1.1KVA, 50–60HZ
	接地方式	D型接地
X射線發生器	機頭轉動	左右30°
	一體型X線管裝置	Canon E7846 (雙焦點 : 1.3 / 0.6 mm)
	迴轉陽極熱容量	110KHU
	總過濾量	2.6mmAl
	高電壓變頻器	功率32KW
過載保護	硬體監控	管電壓、管電流過載自動檢出
		高壓驅動迴路輸入電流檢出迴路
	軟體監控	KV、mAs軟體監控系統
		X射線管過熱監視
準直儀	照射範圍	SID 100cm、0x0cm~43x43cm 連續式
X線管保持裝置	結構	機頭、控制系統一體化設計
X線攝影檯		
SOARMED台製攝影床	檯面尺寸、高度	1350x600mm、地面到檯面高度810mm
	片匣托盤移動量	移動量600mm
	片匣托盤	抽拉式盒式托盤
	使用片匣	(最大)17”X17" ~(最小)8"X10"
日製原裝攝影床（選配）	檯面尺寸、高度	1250X600mm、地面到面高度810mm
	檯面移動量與鎖定	移動量200mm、電池式開關鎖定
	片匣托盤	抽拉式盒式托盤
	使用片匣	(最大“尺寸”)14”X17”～(最小“6切”)8”X10”
腳踏開關	2段式	兩段式腳踏方式
手控開關(選配)	2段式	兩段式按鈕方式

另有四方位攝影床可選配

淬煉的精心設計
成就每一次的拍攝

SOARMED
欣大首美達股份有限公司
TEL:02-27967222 FAX:02-2796-6010
台北市內湖區民權東路六段15巷16號4F-3
soarmed@soarmedical.com.tw www.soarmed.com